ANEXO Nº 03

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -BIENES

Adquisición de:

SENSOR DE SATURACIÓN DE OXIGENO NEONATO PARA OXÍMETRO DE PULSO MASIMO

DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES MÍNIMAS:

ITEM	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
493700210296	04	SENSOR SPO2: **LNCS YI** MARCA: MASIMO MODELO RADICAL 7	• El sensor de SpO2 LNCS **YI** funciona para los Oxímetros: Masimo: Radical 8 Bitmos: Sat 805 Masimo: Radical 7 (con el cable de extensión **Red LNC-10**)
IMAGEN REFERENCIAL	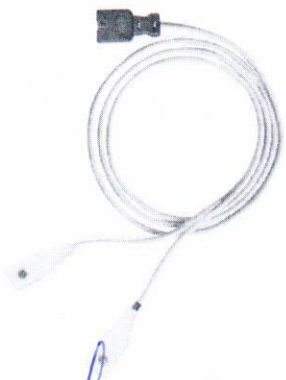		

GARANTIA MINIMA: 01 AÑO

INCLUYE INSTALACION:

SI

NO X

LUGAR DE ENTREGA:

Almacén del Hospital Belén de Trujillo

FIRMA Y SELLO DE JEFATURA

GERENCIA REGIONAL DE SALUD -LL
HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO
Hilario Villanueva Robles
JEFE DEL AREA DE EQUIPO MÉDICO

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
Gerencia Regional de Salud
HOSPITAL BELÉN TRUJILLO
Dra. LUZ H. CISNEROS INFANTAS
Jefe de Departamento de Neonatología
CMP 31316 RNE 13339 – 27976

SE ADJUNTA:

Anexo N°5 –Pedido del SIGA debidamente firmado por jefatura.